



Гигрометр Testo-608-H1/H2 Инструкция по эксплуатации



CE Messgerät konform zu EN 61 326-1:1997
Measuring instrument conforms with EN 61 326-1:1997

Технические данные*:

Измеряемые параметры	Относительная влажность(OB), температура, точка росы (°Стр.)
Сенсоры	Сенсор OB, NTC
Диапазон измерений testo-608-H1	10...95%OB 0...+50°C -20...+50°Стр.
Диапазон измерений testo-608-H2	2...98%OB -10...+70°C -40...+70°Стр.
Точность измерений testo-608-H1	±3%OB ±0,5°C
Точность измерений testo-608-H2	±3%OB ±0,5°C
Разрешение	0,1%OB 0,1°C
Дисплей	Двустрочный
Цикл измер.	18 сек.
Рабочая температура	0...+50°C(608-H1) -10...+70°C(608-H2)
Температура хранения	-40...+70°C
Питание	Батарейка 9В(«крона»)
Ресурс батарейки	Около 1 года
Корпус	Пластик 111x90x40мм
Вес	168 гр.

Прибор 608-H2 имеет световой предупредительный сигнал достижения заданных пределов измерения.

Включение прибора:

- Подключите батарейку(отсек батарейки находится с тыльной стороны прибора), прибор готов к работе.
- При появлении символа (севшая батарейка) прибор может еще работать:
- Testo-608-H1 до 14 дней
- Testo-608-H2 до 8 дней






*Может отличаться от Описания типа средств измерений (<https://oei.by/>).


Текущие измерения

Индикация максимального/минимального измененного значения:



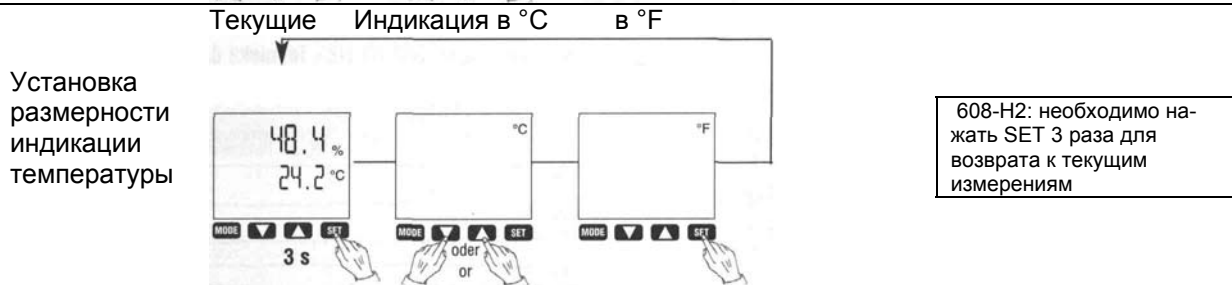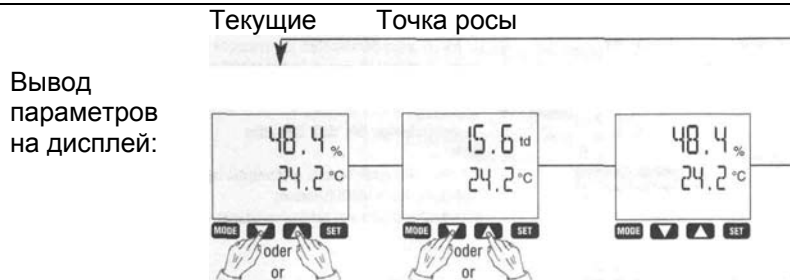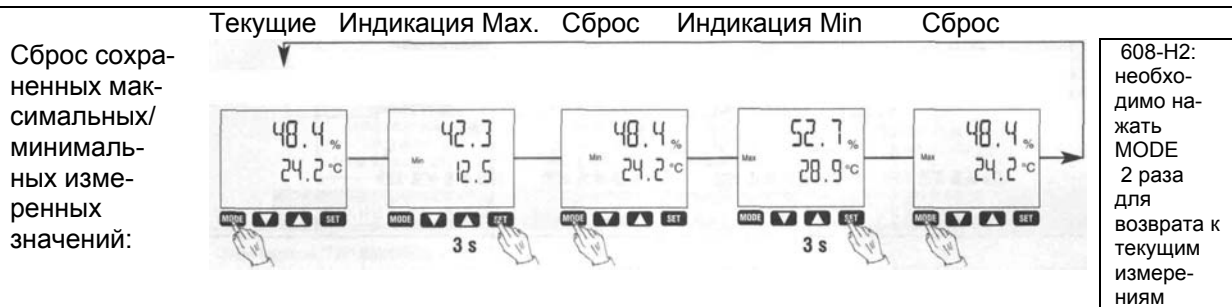

Установка порогов срабатывания светового сигнала (только для модели 608-H2)

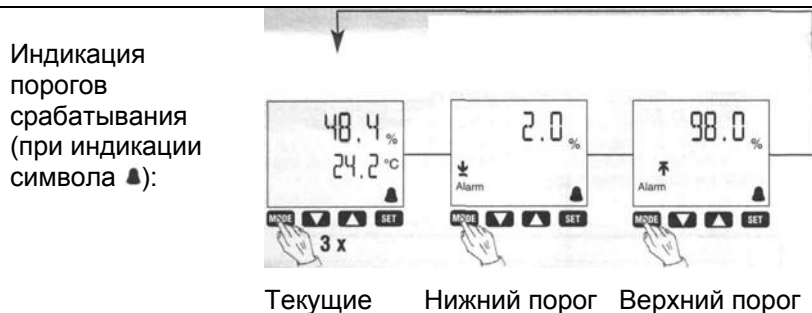


Установка
желаемых
порогов
срабатывания
(при индикации
символа ▲):



Срабатыва-
ние сигнала:

При срабатывании сигнала (мигает красный диод на панели), на дисплее появляется символ соответствующего порога срабатывания (↑-верхний, ↓-нижний).



Для выключения сигнала сбросьте сохраненные Максимальные/минимальные измеренные значения.

При неисправности прибора, свяжитесь с сервисной службой.

Производитель:
Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2 79822
Titisee-Neustadt
Baden-Württemberg
Deutschland
+49 7653 / 681-0
info@testo.de

Официальный дистрибьютор в Республике Беларусь:



ООО «ПРИРОДООХРАННЫЕ И
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Республика Беларусь, 220055, г. Минск,
ул. Игнатовского, д. 4, помещение 121
тел/факс +375 17 310 17 61, +375 44 790 96 66
e-mail: ept@beltesto.by
веб-сайт: www.beltesto.by